

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1)

Ολοκληρωμένο Σύστημα Εμβρυολκίας με ενσωματωμένη αναρρόφηση χειρός, μιας χρήσης και Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator)

Να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εμβρυολκίας με τη βοήθεια κενού, χωρίς την βοήθεια επιπλέον προσωπικού στην Αίθουσα Τοκετού και χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής συσκευής αναρρόφησης εμβρυολκίας.

Να διαθέτει ενσωματωμένη χειροκίνητη αντλία κενού, μια βαλβίδα απελευθέρωσης που ενεργοποιείται με το δάκτυλο (μικρός) και μια ακριβής ένδειξη μέτρησης κενού.

Να διαθέτει ξεχωριστό Δείκτη Δύναμης Έλξης (Traction Force Indicator), το οποίο να μετρά την δύναμη που ασκείται κατά τη διάρκεια της έλξης σε κιλά. Η οπτική αυτή εικόνα και το όριο των (14κιλών) αποτρέπει την αποκόλληση του cup από την κεφαλή του εμβρύου. Η οπτική εικόνα της ελκτικής δύναμης είναι ιδιαίτερα πολύτιμη ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Η χειροκίνητη αντλία κενού που διαθέτει, παρέχει ένα ασφαλές και αποτελεσματικό σύστημα κενού στο χρήστη.


Να είναι διαμέτρου 50 mm , ατραυματική και να μπορεί πολύ εύκολα να στρέφεται σε οποιαδήποτε κατεύθυνση .

Να είναι απλή στη χρήση της με μια κατάλληλη λαβή για κράτημα και εύκολη εισαγωγή.

2)

Ήλιθρες σετ με ασκό 200 ml για χορήγηση φαρμάκων, χρησιμοποιούμενο με ογκομετρικές αντλίες χορήγησης φαρμάκων,

- Οι ανωτέρω ασκοί είναι κατάλληλοι για έγχυση με αντλία : ... και για ρυθμούς έγχυσης 0,1 - 80 ml/h.
- Φέρουν ειδική βαλβίδα-μίας διαδρομής για την πλήρωση του ασκού με φάρμακο.
- Φέρουν ενσωματωμένη βαλβίδα προστασίας ελεύθερης ροής.
- Φέρουν ενσωματωμένο καθετήρα προέκτασης 150 cm με άκρο Luer Lock.
- Φέρουν ενσωματωμένο φίλτρο 0,2μ με ταυτόχρονη κατακράτηση φυσαλίδων
- Έχουν ασκό με χωρητικότητα για 200 cc διαλύματος.
- Είναι κατασκευασμένοι από ειδικό πλαστικό PVC υλικό.
- Φέρονται σε συσκευασία αποστειρωμένη μιας χρήσεως όπου αναγράφονται οι ημερομηνίες παραγωγής και λήξης.
- Προσφέρει ακρίβεια εγχύσεως $\pm 5\%$ με την χρησιμοποιούμενη αντλία
- Είναι κατάλληλοι για όλες τις ενδοφλέβιες ή επισκληρίδιες εγχύσεις.

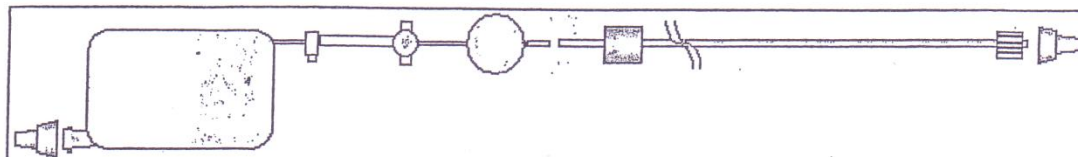

ΓΕΝΙΚΟΙ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

-Γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος ή για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητας.

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, στην τεχνική προσφορά πιστοποιητικό καταλληλότητας CE MARK των προϊόντων που προσφέρουν, από πιστοποιημένο οργανισμό & ISO κατασκευαστή (επίσημα μεταφρασμένα, στην Ελληνική γλώσσα)

-Τα κατατεθειμένα prospectus, θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

-Οι συμμετέχοντες θα πρέπει απαραίτητα, στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά να αναφέρονται για κάθε προσφερόμενο είδος : Α. με τον αύξοντα αριθμό, του πίνακα των ζητούμενων ειδών της διακήρυξης μας, Β. την εμπορική ονομασία – μάρκα - κωδικό, το εργοστάσιο και την χώρα κατασκευής του κάθε είδους Γ. την συσκευασία , Δ. τον κωδικό ΕΚΑΠΤΥ.,

Η προμηθεύτρια εταιρεία σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την κατασκευάστρια να είναι εξουσιοδοτημένη από την κατασκευάστρια εταιρεία για την διακίνηση των προϊόντων της στα ελληνικά δημόσια, Στρατιωτικά και Ιδιωτικά Νοσοκομεία ώστε να διασφαλίζεται η ορθή/ έγκαιρη προμήθεια των προϊόντων στο νοσοκομείο, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία καθώς και την τήρηση όλων των διαδικασιών ή σε πιθανή ανάκληση/ απόσυρση προϊόντος ή μετά από συμπλήρωση της «Κάρτας Αναφοράς Περιστατικών Χρηστών Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (λευκή κάρτα)» από τον χρήστη.